
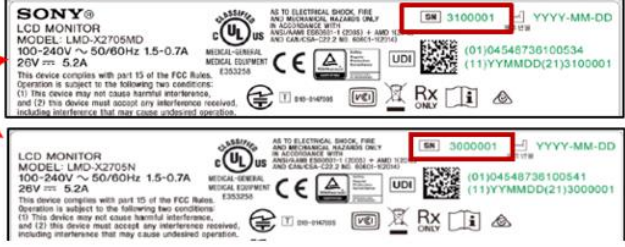




	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Parte posterior del producto</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Número de serie</p>  </div> </div>
<p><b>MEDIDAS QUE DEBE ADOPTAR EL CLIENTE/USUARIO</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifica las existencias de los LMD-X2705MD, LMD-X2705N o LMD-X2700MD afectados.</li> <li>2. Rellena y envía el <b>formulario de acuse de recibo</b> que adjuntamos en esta notificación a la siguiente dirección de correo electrónico: <a href="mailto:Medical-Monitor-Europe@sony.com">Medical-Monitor-Europe@sony.com</a></li> <li>3. Si has distribuido el dispositivo, <b>remite esta carta</b> cuanto antes a los destinatarios e indica los detalles de contacto de los destinatarios en el formulario de acuse de recibo.</li> <li>4. Utiliza más de un monitor o ten disponible un segundo monitor en caso de que se pierda la visualización, como se indica en las instrucciones de uso.</li> </ol>
<p><b>MEDIDAS PREVISTAS POR SONY</b></p>	<p>Sony corregirá todos los productos afectados sin coste alguno. Un representante de Sony se pondrá en contacto contigo para organizar la corrección. Continuaremos investigando el fallo y, en caso de que sea necesario tomar medidas adicionales, te informaremos al respecto.</p>
<p><b>MÁS INFORMACIÓN Y SOPORTE</b></p>	<p>Si necesitas más información o soporte con este problema, ponte en contacto con <a href="mailto:Medical-Monitor-Europe@sony.com">Medical-Monitor-Europe@sony.com</a>.</p>

**Transmisión de esta nota informativa sobre seguridad:**

Remite este aviso a todos aquellos que necesiten estar al tanto en tu organización o en cualquier organización que se utilicen o se hayan transferido los LMD-X2705MD, LMD-X2705N o LMD-X2700MD.

Mantente al tanto de este aviso y de la acción resultante durante un periodo apropiado para garantizar la efectividad de la acción correctiva.

Como procede, ya se ha informado a la autoridad competente de tu país sobre esta acción.

Sony Corporation lamenta las molestias que este problema haya podido causar.

Atentamente,



Henrike Tallis  
Director de asuntos regulatorios y sistemas de calidad de dispositivos médicos  
Sony Europe B.V.

**Nota informativa sobre seguridad urgente**

**Monitores LCD de la serie LMD-X270x de SONY**  
**Puede que no muestre imágenes o que deje de mostrarlas durante su uso**

**Formulario de acuse de recibo**  
**Se requiere una respuesta**

Por la presente, acuso recibo de la nota informativa sobre seguridad y, cuando proceda, confirmo haberlo remitido. Confirmando que he leído y entendido la información de seguridad y que se ha implementado en consecuencia. Envía el formulario completo a: [Medical-Monitor-Europe@sony.com](mailto:Medical-Monitor-Europe@sony.com)

Nombre del cliente/instalación			
Dirección			
Nombre/puesto			
Número de teléfono			
Dirección de correo electrónico			
Firma		Fecha	

Completa según proceda:

- No tengo en inventario el LMD-X2705MD, LMD-X2705N ni LMD-2700MD.
- Tengo en inventario el LMD-X2705MD, LMD-X2705N o LMD-2700MD.
- Nuestros LMD-X2705MD, LMD-X2705N o LMD-2700MD ya no están disponibles y se han descartado.
- He transferido los LMD-X2705MD, LMD-X2705N o LMD-2700MD comprados a las siguientes instalaciones:

	Instalación 1	Instalación 2	Instalación 3
Hospital/organización			
Calle			
Código postal/ciudad			
País			
Número de teléfono			
Correo electrónico			
Persona de contacto			

